

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автоматический интеллектуальный инкубатор «SteadFast»

Модели:

C-12, C-36, C-64, C-100, C-128, C-192, C-200, C-256, C-300



В связи с периодическим усовершенствованием устройства инкубаторов рекомендуем Вам скачать по QR-коду инструкцию с последними обновлениями.

Telegram



Яндекс Диск



Внимание!

**В комплект инкубатора входит пенопластовый короб.
Не выкидывайте его!**



**Популярные товары
«SteadFast»
приобретайте на маркетплейсах!**

Роторные зернодробилки.



**Молотковые зернодробилки с дополнительными опциями:
измельчение початков, корнеплодов, травы, стеблей.**



Аккумуляторные опрыскиватели.



1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Автоматические интеллектуальные инкубаторы «SteadFast» предназначены для разведения домашней птицы.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Инкубаторы оснащены автоматической системой управления, которая регулирует температуру внутри корпуса в заданных пределах в соответствии с выбранным режимом инкубации. Влажность регулируется вручную, путем долива или изъятия излишка воды. Есть функция автоматического поворота яиц и овоскопирования. Устройство работает от сети 220В или от внешнего аккумулятора с напряжением 12В (в комплект не входит). Возможность выбора расстояния между вращающимися роликами позволяет инкубировать разные виды птичьих яиц: куриные, утиные, гусиные, индюшινые, голубиные, перепелиные.

3. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Приступайте к работе с инкубатором, только внимательно изучив руководство.
2. Перед проведением профилактического осмотра, очистки, обслуживания или ремонта полностью обесточьте инкубатор.
3. Запрещается использовать инкубатор при повреждении изоляции сетевого шнура.
4. Запрещается устанавливать на инкубатор и ближе чем на 0,3 м от него любые предметы. Не зачехлять!
5. Запрещается самостоятельно производить ремонт механизмов.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Модель	C-12	C-36	C-64	C-100	C-128
Напряжение переменного / постоянного тока, В.	220 / 12	220 / 12	220 / 12	220 / 12	220 / 12
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Мощность, Вт. до / после набора температуры 37,8 °C	50 / 2,2	130 / 4	130 / 5,1	250 / 8,6	250 / 8,9
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Габариты, мм.	305*285*200	410*405*200	495*460*200	580*570*200	495*460*310
Вес, кг.	1,7	2,8	3,6	4,9	5


Модель	C-192	C-200	C-256	C-300
Напряжение переменного / постоянного тока, В.	220 / 12	220 / 12	220 / 12	220 / 12
Частота, Гц	50	50	50	50
Мощность, Вт. до / после набора температуры 37,8 °C	250 / 8,9	360 / 24	250 / 8,9	360 / 24
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Габариты, мм.	495*460*420	580*572*317	495*460*530	580*570*420
Вес, кг.	6,4	6,6	7,8	8,5

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Модель	C-12	C-36	C-64	C-100	C-128	C-192	C-200	C-256	C-300
Инкубатор	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Пенопластовый короб	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Комплект роликов	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Инкубационная сетка	1	1	1	1	2	3	2	4	3
Комплект автодолива	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Сетевой шнур	1	1	1	1	1	1		1	1
Кабель для подключения АКБ 12 В	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Инструкция	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Упаковка	1	1	1	1	1	1		1	1

6. УСТРОЙСТВО ИНКУБАТОРА

Рис. 1. Устройство инкубатора «SteadFast».

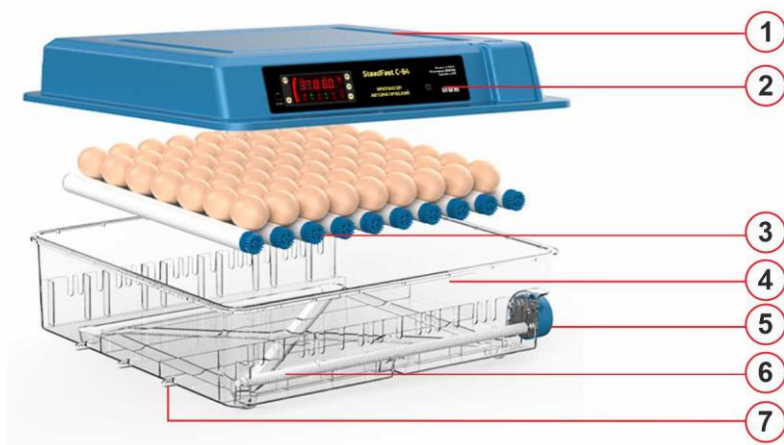

Обозначения для рис. 1:

- Верхний блок: 1. Крышка со встроенными датчиками температуры и влажности
 2. Блок управления 3. Ролики для яиц
 Нижний блок: 4. Нижний корпус 5. Двигатель привода 6. Приводной вал
 7. Штуцеры системы автодолива.

Количество яиц на рис.1 показано схематично без привязки количества к модели.

Рис. 2. Устройство инкубаторов в комплекте со средним блоком.



Модели C-128, C-200

Модели C-192, C-300

Модель C-256

Состав среднего блока:

1. Ролики для яиц
2. Корпус
3. Двигатель привода
4. Приводной вал

Модели C-128, C-200 имеют 1 (один) средний блок.

Модель C-192, C-300 имеют 2 (два) средних блока.

Модель C-256 имеет 3 (три) средних блока.

У моделей C-12, C-36, C-64, C-100 средний блок отсутствует.

Рис. 3. Схема блока управления у моделей C-12, C-36



Рис. 4. Схема блока управления
у моделей C-64, C-100, C-128, C-192, C-200, C-256, C-300.



Обозначения для рис. 3, 4:

1. Разъем для подключения аккумуляторной батареи 12 В
2. Панель управления
3. Встроенный овоскоп (для включения необходимо нажать кнопку «💡» на панели управления).
4. Разъём для сетевого шнура для подключения к сети 220 В.

7. ВКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНКУБАТОРА К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ.

Инкубатор работает от сети 220В. Допускается одновременное подключение инкубатора к сети 220В и аккумулятору 12В. При отсутствии напряжения в сети произойдет автоматическое переключение на работу от аккумулятора. При подключении к аккумулятору 12В важно соблюдать полярность. Провода подключения к аккумулятору 12В входят в комплект.

ВАЖНО! При использовании аккумулятора яйца следует переворачивать вручную, так как механизм поворота роликов отключается. Аккумулятор 12В в комплект НЕ ВХОДИТ.

Рис. 5. Схема подключения инкубатора к резервному аккумулятору 12В



Установка роликов.

Установка роликов на приводной вал инкубатора производится с учетом размеров яиц.

Рис. 6. Пример размещения яиц на роликах.




Вместимость лотка инкубатора (зависит от индивидуальных размеров яиц), шт.

Модель	C-12	C-36	C-64	C-100	C-128
Яйцо куриное	9-12	30-36	55-64	85-100	110-128
Яйцо утиное	8-10	25-30	40-45	64-72	80-90
Яйцо гусиное	6-8	20-24	25-30	42-48	54-60
Яйцо голубиное (перепелиное)	12-15	36-42	64-72	100-114	130-146

Модель	C-192	C-200	C-256	C-300
Яйцо куриное	170-192	160-200	220-256	260-300
Яйцо утиное	120-135	125-140	160-180	200-220
Яйцо гусиное	80-90	85-95	100-120	140-160
Яйцо голубиное (перепелиное)	200-218	210-225	250-292	300-340

С помощью коннектора подключите разъем питания приводного вала к разъему питания управляющего блока. Убедитесь (!), что кабель не задевает шестерни и приводной вал.

Рис. 7. Схема подключения коннектора.

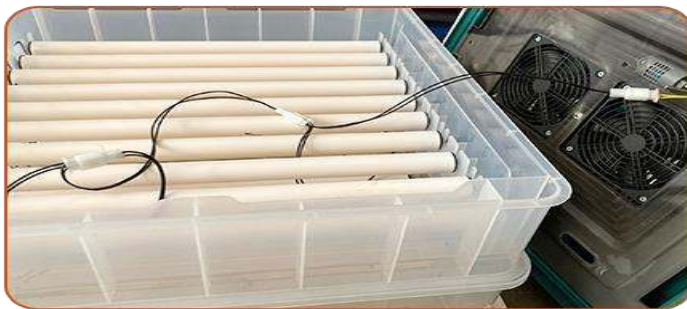

Для удобства наблюдения за вращением можно сделать метку маркером на ролике для установления точки начала вращения.

Нажмите клавишу "+", если ролики начали вращаться, то они установлены правильно, если нет, проверьте правильность подключения разъемов питания.

Если ролики вращаются неравномерно, то измените их положение на приводном валу. Ролики должны вращаться медленно (0,5 об/мин)

Включаются автоматически каждые 120 минут на 90 секунд.

Схема панели управления.

Рис. 8. Панель управления у моделей С-12, С-36



Индикаторы:

"Температура" - показывает текущий показатель в инкубаторе;

"Индикатор нагрева" – сигнализирует (мигает) во время нагрева;

«Индикатор вращения яиц» – сигнализирует (мигает) во время вращения роликов.

Клавиши:

"SET" - позволяет включать режим изменения температуры;

"+" - запускает вращение роликов или прибавляет значения;

"-" - уменьшает значения

"ОВОСКОП" – включает овоскоп, с помощью которого можно быстро отсортировать неоплодотворенные и испорченные яйца;

Заводские настройки по умолчанию.

1. Значение температуры по умолчанию 37,8° С (это заводская настройка, необходимая для инкубации яиц без донастройки).

2. Если для инкубации других яиц необходимо настроить инкубатор, нажмите клавишу SET. На дисплее начнет мигать число, нажимайте "+" или "-", чтобы настроить температуру. Снова нажмите клавишу SET для завершения настройки температуры.

Интервал вращения роликов: 120 минут

Длительность вращения роликов: 90 секунд.

Текущий день инкубации: 1 день

Сброс к заводским настройкам по умолчанию.

Удерживайте одновременно клавиши "+" и "-" в течение 5 секунд.

Рис. 9. Панель управления
у моделей С-64, С-100, С-128, С-192, С-200, С-256, С-300



Индикаторы:

"Температура" и **"Влажность"** - показывают текущие показатели в инкубаторе;

"Heat" (нагрев) – сигнализирует (мигает) во время нагрева;

"Мощность нагрева" - отображает уровень нагрева;

"Alarm" (сигнал) - сигнализирует (мигает и издает звуковой сигнал), когда текущие значения температуры и влажности отличаются от заданных;

"Chicken" (режим «Курица»), **"Duck"** (режим «Утка»), **"Goose"** (режим «Гусь»), **"Pigeon"** (режим «Голубь»), **"Other"** (ручной режим) - отображают выбранные режимы инкубации.

Клавиши:

"MODE" (режим работы) - осуществляет переключение режимов инкубации;

"ОВОСКОП" – включает овоскоп с помощью которого можно быстро отсортировать неоплодотворенные и испорченные яйца;

"SET" (режим работы) - показывает на дисплее установленные значения режима температуры и влажности, а также позволяет менять настройки в ручном режиме;

"+" - запускает вращение роликов или прибавляет значения в ручном режиме;

"-" - отключает звуковой сигнал **"Alarm"** или уменьшает значения в ручном режиме.

Встроенные режимы инкубации

у моделей С-64, С-100, С-128, С-192, С-200, С-256, С-300.

После запуска инкубатора дождитесь, пока температура и влажность станут постоянными, затем выберите необходимый режим инкубации. В инкубатор встроено 5 режимов инкубации яиц - 4 автоматических («Курица», «Утка», «Гусь», «Голубь») и «Ручной режим».

Режим «Утка» - подходит для инкубации индюшиных яиц.

Режим «Голубь» - подходит для инкубации перепелиных яиц.

Для выбора встроенных режимов удерживайте клавишу "MODE" в течение 3 секунд. Выбранный режим отображается в виде соответствующего индикатора на панели управления.

Для изменения режима удерживайте клавишу "MODE" в течение 3 секунд ещё раз. При активации автоматических режимов, инкубатор выбирает температуру и влажность в соответствии с днями инкубационного цикла выбранного режима, ручное управление температурой и влажностью становится неактивным.

При этом инкубатор не регулирует влажность, а лишь контролирует значения влажности и сигнализирует о её слишком низких или высоких значениях.

Влажность регулируется вручную, путем долива или изъятия излишка воды из емкостей в нижней части корпуса инкубатора.

Для просмотра текущих показателей температуры и влажности воспользуйтесь клавишей «SET».

Первое нажатие покажет температуру, повторное нажатие покажет влажность. Последующее нажатие скроет показания.

Ручной режим инкубации у моделей C-64, C-100, C-128, C-192, C-200, C-256, C-300.

Ручное управление доступно только в режиме «Other».

Настройка температуры и влажности:

Нажмите клавишу "SET" - в левой части дисплея начнет сигнализировать значение температуры, в правой части дисплея отобразятся символы «PP», далее нажмите "+" или "-" для настройки требуемой температуры. Снова нажмите клавишу "SET" - в левой части дисплея начнет мигать значение влажности, в правой части дисплея отобразятся символы «HH», далее нажмите "+" или "-" для настройки требуемой влажности. Для сохранения, применения настроек и выхода из меню еще раз нажмите клавишу "SET".

Заводские настройки по умолчанию.

Интервал вращения роликов: 120 минут

Длительность вращения роликов: 90 секунд.

Температура: 37,8°C

Влажность: 60%

Текущий день инкубации: 1 день

Сброс к заводским настройкам по умолчанию.

Удерживайте одновременно клавиши "+" и "-" в течение 5 секунд.

.

**Значения режимов для моделей
С-64, С-100, С-128, С-192, С-200, С-256, С-300.**

Режим «Курица» (инкубация куриных яиц)

Дни инкубации	1-6	7-12	13-18	с 19 и далее
Температура, °С	38.0	37.8	37.6	37.2
Влажность, %	60	55	60	70
Вращение яиц	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	не должно осуществляться

Режим «Утка» (инкубация утиных / индюшиных яиц)

Дни инкубации	1	2-3	4-20	21-25	С 26 и далее
Температура, °С	38.3	38.0	37.8	37.5	37.2
Влажность, %	60	60	55	65	70
Вращение яиц	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	не должно осуществляться

Режим «Гусь» (инкубация гусиных яиц)

Дни инкубации	1	2	3	4-21	22-28	С 29 и далее
Температура, °С	38.5	38.3	38	37.8	37.5	37.0
Влажность, %	65	65	65	55	60	75
Вращение яиц	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	не должно осуществляться

Режим «Голубь» (инкубация голубиных / перепелиных яиц)

Дни инкубации	1-2	3-5	6-11	12-15	с 16 и далее
Температура, °С	38.2	38.0	37.8	37.2	37.0
Влажность, %	50	50	60	65	70
Вращение яиц	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	1 раз в 120 минут в течении 90 сек.	не должно осуществляться

В автоматическом режиме инкубатор по программе самостоятельно поддерживает нужные значения.

Расширенные настройки.

Нажмите и удерживайте клавишу "SET" в течение 3 секунд, пока на дисплее справа не отобразится код - F1. С помощью клавиш "+" и "-" можно изменить значения, клавишей "SET" выполняется сохранение и переключение следующей настройки.

Параметр	Код	Описание	Заводские предустановки
Интервал переворачивания яиц	F1	Интервал переворачивания яиц	120 минут
Время переворачивания яиц	F2	Длительность переворачивания яиц	90 секунд
Калибровка температуры	F3	Калибровка температуры по эталонному термометру	Отображается текущее значение температуры
Калибровка влажности	F4	Калибровка влажности по эталонному гигрометру	Отображается текущее значение температуры
Дни инкубации	F5	Установка инкубации	1 день
Микроинтервалы нагрева	F6	Настройка микроинтервалов нагревательного элемента (рекомендуется значение 5)	5

Внимание! Для случаев, когда температура на дисплее отлична от температуры в инкубаторе, необходимо провести калибровку. Калибровать температуру и влажность в параметрах F3 и F4 можно только в том случае, если вы обладаете достаточным опытом инкубирования и имеете точные измерительные приборы. Неправильная установка значений F3 и F4 может привести к сильному охлаждению или перегреву яиц, что очень пагубно отразится на формировании эмбрионов и выводе цыплят.

Регулировка влажности.

Влажность в инкубаторе регулируется вручную, путем долива или изъятия излишка воды из системы автодолива (рис. 10).

У моделей С-12, С-36 значения влажности можно получить при использовании внешних измерителей влажности для инкубаторов (гигрометров). Приобретается отдельно.

У моделей С-64, С-100, С-128, С-192, С-200, С-256, С-300 значение влажности в инкубаторе выводится на экран панели управления. При достижении недопустимых значений подается сигнал.

Рис. 10. Комплект системы автодолива



Способ установки (рис. 11):

Шаг 1. Присоедините трубку к штуцеру поддона инкубатора.

Шаг 2. Присоедините платформу к трубке с другой стороны.

Шаг 3. Наполните бутылочку водой, закройте крышкой из комплекта и, предварительно перевернув, вставьте её в платформу. Крышка оснащена специальным клапаном, который не позволяет выливаться воде при переворачивании до момента нажатия на клапан.

Рис. 11. Схема подключения системы автодолива



Основание платформ автодолива воды должны быть в одной плоскости с основанием инкубатора (рис. 12)

Рис. 12. Схема установки системы автодолива



Диапазон допустимой влажности на всем протяжении инкубации составляет примерно 50 - 85%, небольшие перепады - допускаются.

За 3 дня до вылупления, влажность должна быть увеличена в соответствии с выбранным режимом инкубации.

Влажность в инкубаторе сильно зависит от влажности окружающей среды. На начальном этапе инкубации рекомендуем установить лишь 1 бутылку в систему автодолива. Далее, выждав от 2 до 4 часов, необходимо проверить влажность, если значение влажности ниже номинального диапазона - увеличьте количество бутылок в системе автодолива.

Если при подключении даже одной бутылки к системе автодолива влажность в инкубаторе превышает допустимый диапазон, то вероятнее всего влажность в вашем помещении слишком высокая.

В таком случае необходимо выставить инкубатор выше уровня основания платформ системы автодолива.

Высота подъема инкубатора относительно платформ системы автодолива устанавливается индивидуально, пока уровень влажности не опустится до необходимого значения.

Если влажность все ещё превышает значения, значит влажность в вашем помещении избыточна – отсоедините бутылку и осушите инкубатор. Во время инкубации на стенках инкубатора и внутри бутылок может образовываться конденсат.

Если влажность внутри инкубатора выше или ниже заданной влажности на 20% - **срабатывает сигнал.**

Температурный режим.

Рекомендуемая температура окружающей среды — от 15 °C до 30 °C.

В комплект инкубатора входит пенопластовый короб. Не выкидывайте его!

Модели C-12, C-36, C-64, C-100 комплектуются коробом только для нижней части инкубатора.

Модели C-128, C-192, C-200, C-256, C-300 комплектуются коробами для нижней и верхней частей.

При низкой температуре окружающей среды, относительно температуры инкубатора, если инкубатор не набирает необходимую температуру - следует использовать пенопластовый короб для утепления и поддержания требуемой температуры.

Перед укладкой яиц сбросьте инкубатор к заводским настройкам и прогрейте инкубатор в течение около 2-х часов, пока температура не достигнет установленного.

Допускаются отклонения по температуре на 0,3-0,8 градуса.

У моделей C-128, C-192, C-200, C-256, C-300 при отклонении температуры внутри инкубатора на 0.8 градуса от заданной - срабатывает сигнал.


Для того чтобы отключить сигнал тревоги – необходимо нажать на кнопку «-»

Рис. 13. Схема установки пенопластового короба на инкубатор.
Слева – пример использования пенопластового кожуха у моделей С-12, С-36
Справа - пример использования пенопластового кожуха у моделей С-64, С100, С-128, С-192, С-200, С-256, С-300



Использование инкубационной сетки.

Рис. 14. Пример размещения яиц на инкубационной сетке.

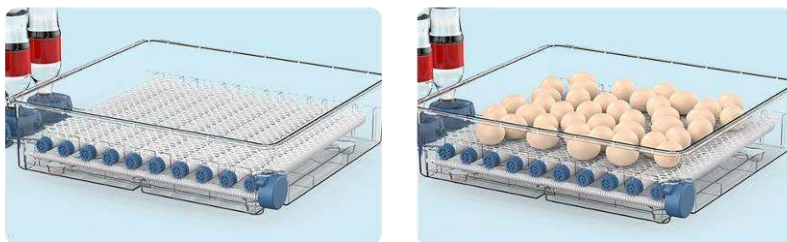

За 3 дня до завершения цикла инкубации необходимо прекратить вращение яиц (отключить коннектор) и установить инкубационную сетку.

Для этого:

- Снимите все яйца с роликов;
- Отключите разъем питания приводного вала от разъема питания управляющего блока;
- Установите инкубационную сетку поверх роликов;
- Равномерно разложите яйца на решетку (рис. 9).

После того как яйца разложены, периодически переворачивайте и при необходимости опрыскивайте их теплой водой для того, чтобы скорлупа размягчилась и процесс вылупления птенцов был более стабильным и равномерным.

Вентиляция и овоскопирование.

При подключении системы автодолива, желательно оставлять открытым один или более штуцеров. Через него происходит приток кислорода.

Овоскопирование проводится на 7 и 14 дни инкубации.

Для проведения овоскопирования установите инкубатор в темное помещение.

Положите крышку рядом с корпусом, подключите инкубатор в сеть и включите овоскоп. Рекомендуем проводить овоскопирование не более 15-20 минут во избежание переохлаждения яиц.




Первый запуск.

Перед запуском обязательно проверьте (рис. 10):

1. Ролики установлены в пазы, шестерёнки в зацепе;
2. Коннектор питания электродвигателя подключен, провод электродвигателя не мешает шестерням роликов;
3. Вентилятор свободно вращается и ему ничего не мешает;
4. Кабель питания подключен к инкубатору и к розетке;
5. При подключении активировался дисплей.

Рис. 15. Схема первого включения.

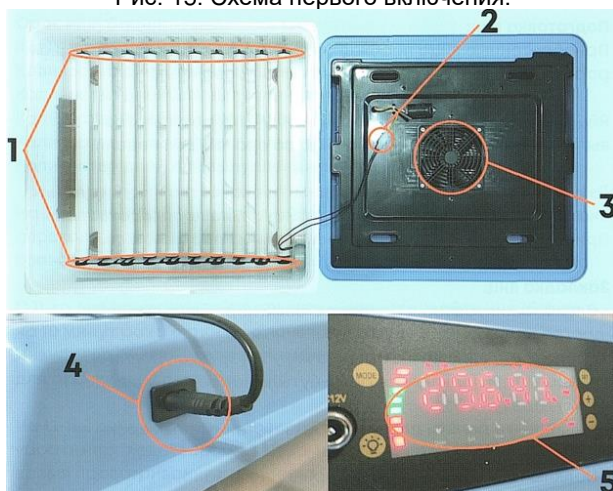

8. ПОРЯДОК ИНКУБАЦИИ.

Подготовка яиц.

Приобретайте яйца только у проверенных поставщиков. Яйца должны быть свежими, для наилучших результатов вылупления нужны отборные яйца со сроком до 1 недели. Результат инкубации сильно зависит от качества инкубируемых яиц. Некоторые яйца могут быть изначально неоплодотворены. Приобретенные яйца необходимо замочить в дезинфицирующем растворе и стерилизовать перед использованием.

Закладка яиц:

- Вложите инкубатор в пенопластовый короб для лучшего прогрева;
- Залейте воду в один из отсеков инкубатора до уровня трубки автодолива и подключите одну бутыл наполненную водой к этому отсеку;
- Установите ролики для яиц в соответствии с размером и видом яиц;
- Подключите разъем питания приводного вала;
- Включите питание инкубатора;
- Накройте верхнюю крышку;
- После того, как температура достигнет нормы, разложите яйца, предварительно нагретые до комнатной температуры, на ролики;
- Вновь плотно закройте верхнюю крышку, процесс инкубации запущен.

Сроки инкубации.

Примерные сроки инкубации:

Вид яиц	Куриные	Утиные	Индюшине	Гусиные	Голубиные	Перепел
Кол-во дней	21	28	28	30	18	18

На 7-й день инкубации начинайте осматривать яйца с помощью овоскопа, наблюдая за развитием эмбриона. На просвете кровеносные сосуды уже должны охватить большую часть яйца.

С 11-го дня приоткрывайте крышку и проветривайте инкубатор на 10 минут раз в сутки не отключая питание инкубатора.

Инкубатор будет издавать сигнал тревоги - нажмите клавишу «-» для отключения сигнала.

На 12-15-й день проведите повторный процесс овоскопии, чтобы убрать неоплодотворенные и замершие яйца. Так же увеличьте время проветривания до 15 минут.

За 3 дня до окончания инкубации прекратите вращение яиц (отключите коннектор), установите инкубационную сетку и переложите на неё яйца.

По мере необходимости доливайте воду в инкубатор в соответствии с установленной влажностью режима инкубации.

По мере вылупления птенцов изымайте скорлупу из инкубатора, чтобы им было больше места.

Увеличьте частоту проветривания.

Весь процесс вылупления может занимать до 48 часов, как только птенцы начнут подсыхать и у них будет расправляться пух, можно доставать их из инкубатора по несколько штук.

9. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ.

Описание неисправности	Метод исправления
Нет питания, дисплей не светится.	Проверьте, подключена ли вилка к розетке и есть ли напряжение в сети.
При использовании аккумулятора 12В дисплей не светится	Проверьте правильность подключения клемм аккумулятора. Проверьте заряд аккумулятора, если напряжение менее 12 В, замените аккумулятор.
Температура не поднимается	Открыто слишком много вентиляционных отверстий. Закройте часть вентиляционных отверстий.
Влажность не поднимается	Открыто слишком много вентиляционных отверстий. Закройте часть вентиляционных отверстий.
Влажность не опускается	Закрыто слишком много вентиляционных отверстий. Откройте часть вентиляционных отверстий или приоткройте на короткий промежуток времени (3-5 сек) крышку инкубатора, чтобы убрать лишнюю влажность. Либо удалите воду из одного из лотков инкубатора.
Не происходит переворот яиц	Проверьте, подключен ли лоток к питанию. Нажмите кнопку «+», для запуска принудительного переворота яиц. Посмотрите, происходит ли вращение. Если лоток повернул яйца, сделайте сброс настроек.
Зазоры при сборке инкубатора	После сборки инкубатора могут остаться зазоры в корпусе. Это не влияет на процесс инкубации.
Запотевание	Запотевание поверхности инкубатора являются нормальным условием. Данный фактор не влияет на процесс инкубации.

10. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ.

По завершению инкубации нижнюю часть инкубатора необходимо освободить от оставшейся воды, высушить и протереть насухо.

Если инкубатор долго не использовали, то его нужно протереть и проветрить до полного высыхания.

Место хранения (транспортировки) должно быть недоступно для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Температура окружающего воздуха при хранении (транспортировке) должна быть в пределах от – 25 до +40 С°.

По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как приступить к эксплуатации оборудования, необходимо произвести подготовительные работы (в том числе первый пуск) согласно инструкции по эксплуатации. В противном случае гарантия не будет иметь силы.

1. Данная гарантия распространяется на модельный ряд инкубаторов **«SteadFast»**.

2. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **9 месяцев** со дня продажи.

3. Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что обнаруженные недостатки и рекламация заявлены в течение гарантийного срока, установленного на изделие.

4. Для гарантийного обслуживания устройство предоставляется в сервисный центр:

- в полной комплектации;
- в чистом виде;

При несоблюдении этих требований сервисный центр имеет право отказать вам в гарантийном обслуживании.

6. Гарантийное обслуживание не распространяется:

- на устройство, которое эксплуатировалось с нарушением инструкции, в том числе, если использовались не рекомендованные производителем расходные материалы, и на инструмент, подвергшийся самостоятельному ремонту или разборке в гарантийный период;
- на устройство, имеющее повреждения, вызванные внешними механическими, термическими, химическими повреждениями, небрежным обращением, стихийными бедствиями;
- на устройство с повреждениями, которые вызваны не зависящими от производителя причинами;
- на устройство, имеющее повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, а также засорением вентиляционных отверстий;
- на устройство, работавшее с перегрузками;
- на устройство с повреждениями, возникшими вследствие эксплуатации с не устраненными недостатками и/или возникшими вследствие технического

обслуживания, ремонта или конструктивных изменений лицами или организациями, не имеющими соответствующих полномочий.

7. Приобретая товар, указанный в настоящем талоне, Покупатель признал, что данный товар соответствует конкретным целям, для которых данный товар покупается, а также соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к товару такого рода и пригоден для использования по назначению. Товар получен в исправном состоянии, в полной комплектации. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено.

8. При покупке изделия в розничном магазине требуйте проверки его комплектации в вашем присутствии, наличия инструкции на русском языке, правильного заполнения гарантийного талона и проведения инструктажа по работе с устройством. Без предъявления данного талона или при неправильном заполнении претензии на качество не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Изготовлено по заказу и под контролем ООО «СТИН+», 443022, г. Самара, пр. Кирова, д.24, корпус 41, этаж 2, комната 2, на предприятии: Нингбо Бай Хайг Импорт и Экспорт Экспресс Ко, Лтд, Адрес: КОМНАТА 705, НОМЕР 555, ЮЖНАЯ ДОРОГА ТЯНЬТУН, УЛИЦА ШУНАНЬ, РАЙОН ИНЬЧЖОУ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Сервис:

ООО «Партнер», 443022, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 24, корпус 3, +7 (846) 211-04-27 доб. 2, servis@stinmarket.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

ВНИМАНИЕ! Талон является действительным при условии заполнения всех полей и наличии печати продавца.

Модель и краткое наименование изделия

Название фирмы-покупателя/ ФИО покупателя (для частных лиц)

Название фирмы-продавца _____

Дата продажи _____

Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил. С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена мною в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

(Ф.И.О. подпись покупателя)